BIGG - MASTER

PMP-002

PMP-001

PMP-003

CE LATEX

URZĄDZENIE REHABILITACYJNE

BIGG MASTER

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent urządzenia rehabilitacyjnego
AKSEL
PL 05-800 Pruszków
ul. Guzikowa 28
peni@aksel-gmbh.com.pl

NOTATKI:

PL

PL

Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie Bigg Master.
Wyprodukowano w całości w Polsce.
Instrukcja pomoże Ci poprawić kształt Twojego penisa.

Funkcja

W połączeniu ze specjalnie przystosowanymi częściami, prętów, szelek i pasów do naciągu pozwala na trening penisa w różny sposób.

W ramach leczenia i wydłużania, fizjologicznie skuteczne siły ciągnące odnoszą się do całego penisa. Podobnego do treningu siłowego, wspomniane wyżej wyniki w tkankach komórek są coraz bardziej wydajne (poprawa libido) oraz w nowych tkankach powstających podczas kształtowania, sposobu (wydłużenia, pogrubiania i prostowania penisa).

Bigg Master zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfort i higienę podczas noszenia.

Szereg unikalnych i innowacyjnych cech konstrukcyjnych pozwala na wydłużenie okresów stosowania, a tym samym najlepszego leczenia.

Części składowe są na nowo opracowane, a dyskretne zastosowanie i montaż przyrządu, zapewniają prostą obsługę w długim czasie użytkowania.
Bigg Master jest praktycznie nie zauważalny podczas noszenia.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytać ten instrukcję obsługi.

Instrukcja zapewnia szczegółowy opis krok po kroku z montażem, eksploatacją i sposobem czyszczenia.

Ponadto dowiesz się wszystkiego na temat funkcjonalności tego urządzenia.

Dalsze informacje, aktualizacje, akcesoria, części zamienne i eksploatacyjne, a także pytania i odpowiedzi otrzymasz pisząc pod adres:
peni@aksel-gmbh.com.pl

Spis treści

Strona

Ważne cechy produktu 8
Obszary zastosowania - Przegląd 8
Znane zagrożenia i skutki uboczne 9
Wprowadzenie 10
Co to jest Bigg master ? 10
Obszary stosowania i efektów 10 terapii 10
Zasada działania Bigg Master 12
Specyfika Bigg Master 12
Trzy różne siły fizyczne mocowania żołądzia 13
1. Techniki mocowania 14
2. Przyczepność - zasada przylegania 15
3. Zasada przyssawki, podciśnienie 16
Instrukcja użytkowania Bigg Master 17
Przegląd systemu Bigg Master **(system podstawowy)** 18–19
Montaż Bigg Master 20
1. Zamknięcie zaworu 21
2. [opcjonalnie] - Wstawianie podziału adaptera 21
3. Montaż membrany 22
4. Podłączenie pierścienia śluzy i śluzy 22
5. Podłączenie do komory żołądzia śluzy 23
Zastosowanie Bigg Master **do penisa** 24
Preparat do stosowania 24
1. Dystrybucja preparatu 24
2.1 Wariant: aplikacja z pompką 25
2.2 Wariant: aplikacja z systemem wężyka (akcesoria) **Czyszczenie systemu aplikacji wężyka** 27
Po włożeniu żołądzia do Bigg Master 29
Zdejmowanie Bigg Master 29
Czyszczenie Bigg Master 30
Odpowiednie środki myjące i metody 31
1. Odpowiednie środki myjące i metody ..... .
2. Szybka metoda czyszczenia 31
3. Oczyszczanie raz dziennie podczas aplikacji 31
4. Suszenie bez demontażu elementów lateksowych 32
Bigg Master **z naciągiem szelkowym** 33

PL

Lista części i oznaczenie części Bigg Master 36–37
Pas biodrowy wariant noszenia 38
Preparat do stosowania 38
Zastosowanie jako szelek naciągowych 38
Pasek na ramię wariant noszenia 39
O tym sposobie wariantu 40
Informacja o regulacji 40
Zastosowanie szelek na ramię 40
Pasek na kolano wariant noszenia 41
O tym sposobie wariantu 43
Informacja o regulacji 43
Zastosowanie szelek na kolanie 43
Czyszczenie i konserwacja 44
Bigg Master **z prętami dystansowymi** ® 45
Lista części Bigg Master z prętami dystansowymi ® 46
Montaż prętów dystansowych 47–48
Zastosowanie urządzenia z prętami dystansowymi 49
..... 49
1. Ustawienia długości prętów dystansowych 50
2. Podłączenie do Bigg Master 51
3. Regulacja siły ciągnącej 53
Czyszczenie i konserwacja 53
Instrukcje szkoleniowe Bigg Master 54
Czas trwania i częstotliwość stosowania 54
Ile godzin dziennie powinno się nosić Bigg Master ? 54
Jaki jest całkowity czas noszenia Bigg Master ? 55
Czy przerwy w stosowaniu mają negatywny wpływ na wynik? 56
Prawidłowa siła ciągnąca; regulacja siły ciągnącej 57
Wniosek - powinien być wygodny w każdej chwili! 57
Zastosowanie podczas snu 58
Bigg Master **w połączeniu z innymi metodami** 58
Tabletki i maści do powiększania penisa 58
Techniki masażu 59
Pompki próżniowe 59
Suplementy diety, żywienie 59
Dane producenta 60

PL

Podręcznik
Urządzenie rehabilitacyjne

PL

Ważne cechy produktu

- fizjologiczno-anatomiczne zastosowanie funkcjonalnego urządzenia
- zastosowanie do połączenia próżni, przyczepności i dopasowanie (!)
- opcjonalnie stosowane z olejkiem do smarowania (!)
- dostosowuje się do kształtu penisa bez uciskania
- dla każdego rozmiaru penisa, odpowiedniego do obrzezanych i nieobrzezanych mężczyzn
- ochrona napletka i limfy
- można nosić z paskiem lub z prętami
- bezwzględnie wygodne
- może być noszone bez pompki, prosta obsługa
- łatwa procedura oczyszczająca, idealna higiena dzięki lateksowej hermetyzacji punktów kontaktowych

Obszary zastosowań - Przegląd
Pola plastikowe, aplikacja kosmetyczna

- powiększenie penisa / wydłużenie penisa
- zgrubienie penis (rozszerzenie obwodu prącia)
- prostowanie penisa
- rozszerzenie i kształtowanie żołądzia prącia
- ogólna poprawa libido

Obszary zastosowania terapeutycznego

- w przypadku choroby Peyroniego, Induratio penisa plastica (IPP, wyczuwalne stwardnienie w penisa)
- w przypadku reakcji (cofania / skracania) prącia (np po usunięciu prostaty, u starszych mężczyzn na podstawie zmniejszenie aktywności seksualnej i regulacji hormonalnej, w przypadku nadwagi)

- w przypadku Ejaculatio praecox (przedwczesny wytrysk)
- w celu poprawy zdolności erekcji i twardości erekcji

Znane zagrożenia i skutki uboczne
Jeśli Bigg Master jest prawidłowo stosowany, mechaniczne działania mogą spowodować wzrost przepływu krwi, a tym samym niewielkie zaczerwienienie żołędzia, w którym to szybko ustępuje po usunięciu urządzenia.
W oparciu o wysoki poziom komfortu, większe siły ciągnące niż zalecane 200 - 1100 g mogą być przenoszone łatwo na żołądź. W wyniku przeciążenia siły ciągnącej może nastąpić tymczasowe opuchnięcie żołędzia i / lub częściowo zabarwieniu białawym, po czym same zwykle ustępują znacznie po już kilku minutach.

W przypadku niewłaściwego stosowania ciągnące siły przekraczające normę mogą prowadzić do powstawania pęcherzy w żołądziu, które ustępują w ciągu kilku godzin, po usunięciu urządzenia. Niepotrzebnie silne podciśnienie może powodować obrzęk napletka jeśli jest zasysany częściowo do komory próżniowej. Wszystkie skutki uboczne opisane i powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania są tymczasowe i zauważalne również z wyprzedzeniem przez swędzenie lub zaognienie.

PL

Tak więc, urządzenie powinno być usunięte, w przypadku zauważenia objawów i powinno być ponownie prawidłowo zastosowane zgodnie z instrukcją po zmniejszeniu się objawów i zastosowania mniejszej siły ciągnięcia.

Kiedy urządzenie nie powinno być stosowane ?
W przypadku problemów żylnych lub słabości tkanki łącznej w obrębie penisa lub innych kwestii, jak odniesieniu do penisa lub cewki moczowej należy skonsultować się z lekarzem, urologiem.

W celu zapewnienia naturalnego odczucia ciała i bólu podczas aplikacji, ze względów bezpieczeństwa urządzenia nie należy stosować w następujących przypadkach:

- pod wpływem alkoholu
- pod wpływem narkotyków
- pod wpływem środków uspokajających
- pod wpływem narkotyków lub leków nasennych i obniżenia świadomości bólu
- w przypadku uczuleń na lateks.

PL

Wprowadzenie

Co to jest Bigg Master ?
Bigg Master jest anatomicznie ukształtowany w celu dostosowania połączenia żołędzia prącia. Urządzenie zapewnia fizjologicznie prawidłowe zamocowanie żołędzia, aby być w stanie wydłużyć penisa poprzez zastosowania siły ciągnięcia urządzenia.
Produkt jest odpowiednia dla mężczyzn w każdym wieku, dla nieobrzezanego i obrzezanego penisa i odpowiada każdemu kształtowi żołędzia, a tym samym wielkości prącia.

Obszary zastosowania i efektów terapii.
W oparciu o wysoki poziom komfortu Bigg Master
delikatne wydłużenie penisa można uzyskać i zauważyć jego seksualnie inspirujący efekt bezpośrednio po aplikacji.

Mimo, że nie jest jeszcze zauważalne wydłużenie, świadomie po bardzo krótkim okresie czasu, penis jest stale w podświadomości mózgu w każdej chwili za pomocą ww.

To biologiczne sprzężenie zwrotne może mieć bardzo pozytywny wpływ na seksualne odczucia.

W zależności od czasu trwania aplikacji, tymczasowe efekty motywują w celu osiągnięcia trwałych efektów.

Jeśli urządzenie stosuje się przez co najmniej trzydzieści minut dziennie:

- • powiększenie penisa i żołądzia w stanie zwiotczenia do maksymalnych wymiarów naturalnych.

Jeśli stosuje się kilka godzin dziennie przez okres co najmniej czterech tygodni:

- powiększenie penisa i żołądzia w ich stanie zwiotczenia do maksymalnych wymiarów naturalnych trwa kilka godzin
- tymczasowe wymierne i widoczne powiększenie penisa w stanie zwiotczenia
- poprawić zdolność erekcji w przypadku niewielkiego erective zaburzenia erekcji
- poprawa w przypadku przedwczesnego wytrysku (Ejaculatiopraecox)
- poprawa seksualnego libido

Jeśli zastosowano kilka godzin dziennie przez okres kilku miesięcy:

- trwałe wydłużenie, pogrubienie i prostowanie penis w stanie wiotkim i wzniesionym
- Szczególnie na początku stanu nienormalnego wrodzonego z formującą krzywizną (Induratio penis plastica, IPP),
- Krzywizny prącia można przeciwdziałać. Zaawansowane IPP mogą być złagodzone.

PL

Przy zastosowaniu Bigg Master część ciała staje się coraz większa i zmienia swój kształt, gdy organizm buduje nowe komórki organizmu w obrębie tego samego.
Jeśli penis ma stać się większy, grubszy lub prostrzy po zakończeniu procesu wzrostu naturalnego, który następuje w wieku 19 lat, tkanka mięśniowa sama wymaga długotrwałej stymulacji,
która pobudza do dalszego wzrostu komórek naprawczych.

PL

W tym Bigg Master pobudza penisa poprzez siłę ciągnienia.
Zabieg jest rewitalizacją wydłużenia tkanki prącia, który jest zdolny do poprawy erekcji.
Siła i libido i może być pomocne z terapeutycznego punktu widzenia.

Zasada stymulacji za pomocą wydłużania część ciała jest wykorzystywana w dziedzinie ofthe-ortopedii i chirurgii, a środki zwiększające objętość są używane w medycynie na przykład wydłużenia kości.

Specyfika Bigg Master

Penis jest elastycznym organem bez trwałej struktury kości mający najbardziej różne rozmiary i twardości, w zależności od warunków przepływu krwi.

Z tego powodu penis na przykład jest często znacznie mniejszy i miększy podczas kąpieli w zimnym morzu, w porównaniu do stanu erective.

W oparciu o wyżej wymienione powody jest to bardzo trudne zadanie, aby poprawić penisa w sposób, by funkcje fizjologiczne, takie jak przepływ krwi lub czułość były utrzymywane.

Konstrukcja Bigg Master uwzględnia anatomiczną budowę penisa.
W ten sposób, Bigg Master jest idealny do wydłużenia poprzez równomierne ciągnięcie penisa na całej jej długości. Bigg Master może być używany natychmiast po operacji na penisie w celu zapobiegania bliznom (np korekcji z Induratio penisa plastica) jak i również na bardzo krótkie penisy.

Bigg Master dopasowuje się samoczynnie do kształtu i rozmiaru żołądzia, niezależne od erective a nie żołądzia do systemu. Podczas aplikacji penis żołądzia może się powiększyć lub staje się mniejszy. Moduł utrwalania dostosowuje się do dowolnej ilość cykli montażowych z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności.

[!] Techniki mocowania na podstawie ściskania, tarcia lub usztywnienia (Tak zwane "połączenie cierne") nie są używane w tej zaprojektowanej koncepcji.

Wynik
Bigg Master utrzymuje penisa w wydłużonej pozycji w absolutnie niezawodny sposób, nawet jeśli same nie mogą już być ustalone i wymyka się na ze względu na pot lub olejek.

PL

Bigg Master łączy w sobie następujące fizyczne siły:
1. Skuteczne blokowanie fit - Zasada hak holowniczy
Dopasowany uchwyt jest najbardziej stabilny mechanicznie i mocny. Dopasowanie uchwytu łączy ciało w nieodłączny sposób, siła jest przenoszona niemal bez straty.

Lateksowa membrana automatycznie dostosowuje się do kształtu żołądzia, ma grubość tylko 0,3 mm.
Wprowadzany do komory żołądź do Bigg Master zostaje w nierozerwalny sposób - bez ucisku i otarcia. Przy tym membrana rozciągnięta na zasadzie podciśnienia zachowuje kształtu żołądzia nawet jeśli siła ciągnąca jest zastosowana.

Wewnętrzny kontur komory żołądzia jest dostosowany do kształtu żołędzia i przyczynia się do tego, że sam nie może się wyślizgnąć z urządzenia. W celu dalszego dostosowania kształtu obwodu penisa można zastosować adapter (pierścień) włożony do otworu. W ten sposób urządzenie może być dostosowane w możliwie najlepszy sposób dla każdego człowieka.

Za pomocą wyżej wymienionych, membrany i żołądzia komora trzyma się bezpiecznie z Bigg Master.

Ten uchwyt jest utrzymywany za pomocą adaptacyjnej przepony, nawet jeśli żołądź się powiększa lub zmniejsza w czasie aplikacji.

Bigg Master może być noszony bez znacznego stosowania nacisku na żołądź.
2. Przyczepność - zasada klejącą jak krem na sztuczne zęby
Siła przyczepności wynika z głębokiego, anatomicznego kształtu i powierzchni kontaktu membrany.

PL

3. Próżniowe, które mogą być dozowane - zasada przyssawka

Delikatne podciśnienie w Bigg Master jest przeznaczone przede wszystkim do zastosowanie membrany wokół adaptacyjnego żołądzia dostosowany anatomicznie w spójny sposób, a tym samym do przytrzymania w odpowiedniej stabilnej pozycji.

PL

Dzięki próżni mając tylko pośredni wpływ na żołądź, pęcherzyki, obrzęki limfatyczne, lub zdolnościami z tkanki tlenu (hipoksja) są zabezpieczone w sposób efektywny.

Ponadto, jak żołądź nie musi być dociśnięta ściany wewnętrznej komory utworzonej za pomocą pompki próżniowej.

Próżnia wewnątrz Bigg Master ostatecznie jest tak niska jak to możliwe, może być dozowana do każdego rozmiaru żołądzia.

Instrukcja użytkowania Bigg Master

Aby móc korzystać z nowego systemu Bigg Master w sposób idealny, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

W zależności od tego, czy chcesz korzystać z Bigg Master jako metalowych prętów dystansowych lub systemu szelek, proszę czytać odpowiednie rozdziały.

Należy również przestrzegać wskazówek oznaczonych specjalnie.

Można znaleźć więcej informacji pisząc do nas.

Przegląd systemu Big Master (system podstawowy)

PMP – 001

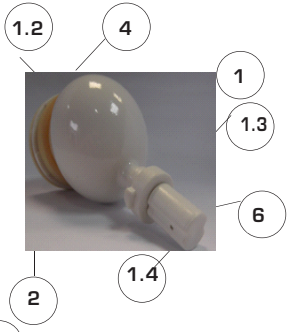



1 **Kpl komora na żołądź**

PMP-001

1.1 **Anatomiczna komora żołądzia**

EPMP-001

Anatomiczny kształt wydrążenia komory podłączania żołądzia Membrana przylegania (4), za pomocą próżni. Na podstawie nachylonego otworu, wrażliwy napletek wędzidełka pozostaną poza strefą podciśnienia.

1.2 **Łącznik z rowkiem** do mocowania elementów lateksowych (3 i 4).

1.3 **Głowica zaczepowa**

Łączy komorę żołądzia (1,1) z uchwytem prętów ciągnących (nie pokazaną).

1.4 **Zawór**

[nie widoczny]

Z gwintem na standardowy zawór obrotowy (6), a przewód obrotowy Zawór (8.1).

2 **Pierścień do śluzy**

EPMP-002

Dla łatwiejszego wkładania żołądzia do śluzy (3).

3 **Śluza z miękkiego lateksu**

VPMP-001 (zestaw)

Zapobiega przenikaniu powietrza pomiędzy membraną żołądzia (4).



4 Anatomiczne adaptacje przyczepności membrany z miękkiego lateksu

VPMP-001 [zestaw]

Dostosowuje się do kształtu i rozmiaru żołądzia w fizjologicznie elastyczny sposób i przesyła siłę ciągnącą do prącia.

5 Podzielony Adapter (dwa rozmiary)

EPMP-004

Dla optymalnej adaptacji komory żołądzia (1.1), do mniejszej średnicy penisa. Zwalnia się automatycznie po usunięciu Bigg Master

Standardowy zawór obrotowy

EPMP-003 I

Nie przepuszcza powietrza, jeśli wkręca się w dół (w lewo)

7 Zastosowanie systemu pompki

EPMP-005

Dla ułatwienia stosowania Bigg Master wytwarza nadciśnienie lub próżnię. Z adapterem zaworu automatycznego (7,1) z mechanizmem zamykającym dla komory żołądzia (1.1).

8 System połączenia wężykiem

ZPMP-002

Dla zastosowania Bigg Master zgodnie z zasadą słomki. Z zaworem do wężyka wtyczki (8.1), uszczelnienie (8.2), złącze wężyka (8.3), a rozszerzenie wężyka [8.4]. Mieści się w każdej kieszeni.

9 Żel silikonowy i pielęgnacja

ZPMP-001

Ułatwia procedurę składania, poprawia komfort, i utrzymuje lateksowe części (3 i 4).
Film przyczepności pomiędzy odpornym lateksem i żołądzią, w którym to nie jest zanurzony. Zastosowanie jest bardzo wydajne. Nie wywołuje uczuleń.

Montaż Bigg Master

W stanie fabrycznym Bigg Master jest gotowy do działania. Proszę przestrzegać następujących wskazówek odnośnie wymiany lub czyszczenia wstępnie zmontowanych części.

PL

Całkowicie zmontowany Bigg Master

Uwaga:
Części lateksowe mogą być uszkodzone przez paznokcie !

Paznokcie mogą spowodować uszkodzenie części lateksowych

KRÓTKA INSTRUKCJA

1. Zamknięcie zaworu

Przykręcić zawór w lewo, całkowicie w kierunku do dołu. Rowki boczne muszą być zgodne z lamella.

2. [opcjonalnie] - Wstawianie podziału adaptera

Uwaga:

Bigg Master może być ustalony w dowolny sposób do każdego żołędzia, jednakże dostosowanie przysłony do średnicy penisa za pomocą

Adaptera podziału może dodatkowo zwiększyć komfort noszenia oraz

ustalania wydajności, szczególnie w przypadku większych sił ciągnących.

W celu wybrania odpowiedniego podziału adaptera, należy przedłużać

penis i pomiar średnicy z samego tyłu żołądzia.

Jeśli penis ma średnicę:

- więcej niż 24 mm: Nie stosuje się adaptera
- od 19 - 24 mm: Stosuje się wąski adapter
- mniej niż 19 mm: Stosuje się szeroki adapter

a) Proszę trzymać komorę żołądzia w kierunku góry

b) Włóż połowę adaptera.

c) Naciśnij drugą połowę adaptera przed pierwszym i naciśnij zarówno w kierunku ku dołowi do zainstalowania.

1. Zamykanie zaworu

2. a - c] Opcjonalnie włóż adapter podziału

PL

3. Montaż membrany

a) Proszę trzymać komorę żołądzia z wskazując w górę.
b) Umieścić membranę na komorze za pomocą ruchu obrotowego.

Uwaga :

Membrana powinna być naciągnięta na komorze o średnim napięciu.

Uwaga:

PL

Wolny koniec śluzy musi wystawać od strony pierścienia śluzy z czterech podpórek

Uwaga:

Instalowanie adapterów są przed mocowaniem membrany.

4. Podłączanie pierścień śluzy i śluzy

a) Za pomocą ruchu obrotowego zamocować jeden koniec do pierścienia z rowkiem do śluzy [1].
b) Wciśnij drugi koniec przez pierścień śluzy [2].

Uwaga:

Wolny koniec śluzy musi wystawać od strony pierścienia śluzy z czterech podpórek

KRÓTKA INSTRUKCJA

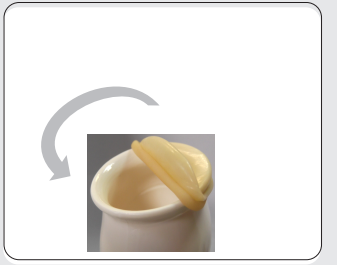

3. a-b] Instalowanie membrany

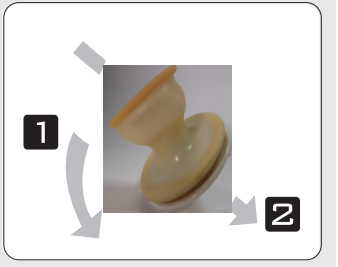

4. a - b] Podłączanie pierścień śluzy i śluzy

5. Podłączenie do komory żołądzia śluzy za pomocą ruchu obrotowego, umieścić swobodny koniec śluzy na zgrubieniu membrany nałożonej na komorę w sposób obwodowy

[!]. Przy wykonywaniu wyżej wymienionych, po raz pierwszy będzie to wymagać pewnej praktyki.

Uwaga 1:

Koralik śluzy ma być wprowadzone w ciągu (!) rulonik śluzy ma leżeć równo na membranie, ponieważ zapobiega to powolnemu przenikaniu powietrza do komory żołądzia podczas stosowania.

Uwaga 2:

Pierścień śluzy powinien wykorzystywać wszystkie cztery dystanse i delikatnie dociskać do komory żołądzia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, prawidłowe położenie i pierścienia śluzy za pomocą palca ułożyć do otworu.

Uwaga 3:

Całkowicie zainstalowana śluzy musi zostać ułożona symetrycznie w środku i powinna mieć średnice ok. 12 -15 mm.

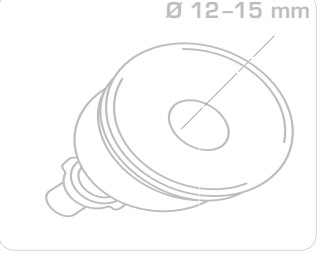

KRÓTKA INSTRUKCJA

5. Umieścić część śluzy na części membrany i naciągnąć ruchem obrotowym

Kompletnie zmontowany Bigg Master

PL

PL

Zastosowanie Bigg Master do penisa

Przygotowanie do stosowania
Higiena

Uwaga:

oczyścić i odtłuścić penisa. Proszę oczyścić penisa i żołądź przed każdym użyciem aplikacji wodą i mydłem.

Uwaga:

Aby wstawić żołądź i uzyskać odpowiednią przyczepność zalecamy używanie specjalnie dostosowanego żelu.
Żel służy do pielęgnacji i jest objęty zakresem dostaw na zamówienie. (pozycja nr ZPMP – 001). Alternatywnie mżna używać olejków (najlepiej o średniej lepkości) na bazie silikonu.
[!] Kremy i oleje zawierające tłuszcz mogą powodować uszkodzenia lateksu.
[!] Ślina może zawierać zakaźne zarazki.

1. Nakładanie żelu

Stosuje się kilka kropli żelu (patrz wyżej) do wewnątrz śluzy, na membranę. Dla tego, nieznacznie podnieść pierścień śluzy, aby było możliwe zwilżenie całej powierzchni membrany.

Wnętrze części lateksu mają być pokryte cienką warstwą żelu (!)

Miejsce, obejmujące rowek komory żołądzia musi pozostać suche, ponieważ części lateksowe mogą się zsunąć !

Uwaga:

Procedura wkładania może być jeszcze ułatwiona, jeśli żołądź jest pokryty małą ilością żelu.

KRÓTKA INSTRUKCJA

Uwaga:
U zaawansowanych użytkowników procedura zakładania trwa łącznie ok. 30 sekund.

1. Nakładanie żelu na membranę

WSKAZÓWKA:
Przystaw żołądź do jej średniej wielkości
Stymulować penis, w celu powiększenia żołądzia trochę
na wiotkim stanie. Penis nie powinien wypełniać komory zupełnie!

2. Zastosowanie Bigg Master do penisa

Uwaga:

Zawór obrotowy musi być zakręcony! (w lewą stronę)

2.1 Wariant: Zastosowanie pompki

a) Trzymaj Bigg Master w widoku z boku, jak pokazano na rysunku. Trzymaj pompkę z drugiej strony w taki sposób, że oznaczenia punkt adaptera zaworu są w kierunku do góry.

b) Ścisnąć pompkę prawie całkowicie.
[!] Trochę powietrza powinny nadal pozostać w pompce!

c) Umieścić adapter zaworu na zawór obrotowy Bigg Master [1].

d) Natomiast komora żołądzia przekręć o ćwierć obrotu w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara [2].

e) Następnie naciśnij pompkę, w celu utworzenia łuku na membranie lekko na zewnątrz.

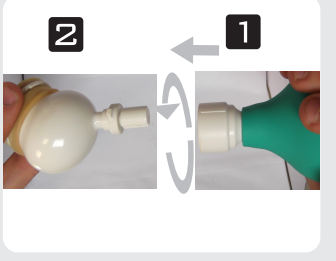

PL

PL

[!] Dla nieobrzezanych penisa (z napletka)

Odciągnąć napletek.

f) Delikatnie (!) naciśnij żołądź do otworu śluzy.
g) Powoli wypuścić pompkę i włożyć do komory żołądzia żołądź w celu zassania. Zajmie to między trzy do dziesięciu sekund. W ten sposób powietrze nie powinno wnikać między żołądź i przeponę, jeśli to możliwe. Gdy pompka jest pełna, osiągnęła wielkość zwolnienia, należy poczekać kilka sekund jak system będzie nadal ssać powietrze.

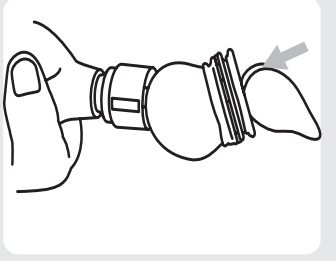

2. f - g) Powoli wypuścić pompkę i włożyć do komory żołądzia żołądź w celu zassania.

Uwaga:

W przypadku gdyby żołądź nie został zassany do komory żołądzia całkowicie, ponownie należy powtórzyć procedurę.

h) Obróć pompkę w przeciwnym kierunku i ją usuń.
Jeśli system nie jest trwale nieprzepuszczalny dla powietrza za pomocą wyżej wymienionych, zacisnąć zawór obrotowy nieco bardziej (w lewo)

2. h) Obróć pompkę w przeciwnym kierunku i ją usuń

Po włożeniu żołądź w Bigg Master na stronie 29.

2.2 Wariant: Aplikacja w systemie - Wężyk

1. Przygotowanie do aplikacji

a) wyciągnąć wtyczkę z zaworu zamykającego wąż.
b) włóż złącze węży do węża zaworu [1].

c) przykręcić zawór węża w kierunku ku dołowi [2].**(w lewo)**

KRÓTKA INSTRUKCJA

1. a) Zdjąć korek zamykający

PL

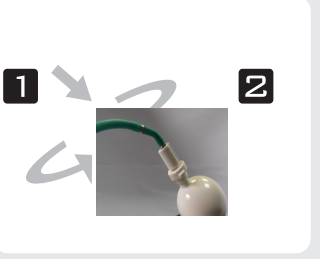

*1. b - c) Zatkać przewód przedłużający do zaworu wężyka, wężyk z nakrętką przykręcić zawór na komorę żołędzi (**w lewą stronę**)*

PL

2. Zastosowanie w systemie aplikacji wężyk

a) Włożyć wężyk przedłużający do ust tak jak słomkę.

b) dmuchnąć małą ilość powietrza do wężyka, w celu wypchnięcia membrany lekko na zewnątrz.

Ważne w razie problemów:
Jeśli nie jesteś w stanie dmuchać w ani ssać powietrza, należy otworzyć Zawór o kilka milimetrów, obracając dokładnie do momentu aż będzie to możliwe.

Uwaga:
[!] Dla nieobrzezanych penisa (z napletka)

Odciągnąć napletek.

c) Delikatnie (!) naciśnij żołądź do otworu śluzy.
d) dmuchnąć w wężyk powoli i mocno kilka razy i wstawić żołądź całkowicie do komory żołądzia, przez ssanie. W ten sposób powietrze nie powinno wnikać pomiędzy żołądź i membrany, jeśli jest to możliwe.

Uwaga:
Podczas przerw w oddychaniu naciśnij językiem otwór węża, tak że powietrze może przepływać z powrotem!

KRÓTKA INSTRUKCJA

2. a - b) dmuchnąć małą ilość powietrza do wężyka, w celu wypchnięcia membrany lekko na zewnątrz.

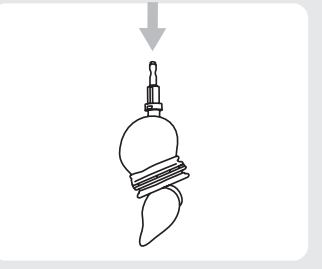

2. c - d) wstawić żołądź całkowicie do komory żołądzia, przez ssanie.

e) **Mocno ścisnąć zawór wężyka [1],**
odłączyć rozszerzenie wężyka i podłączyć wtyczkę do zaworu uszczelniającego z wężem [2].
Proszę dokonać kontroli "Po włożeniu żołądź w Bigg Master na stronie 29.
Oczyszczanie systemu aplikacji węża.
Jeśli to konieczne, można oczyścić za pomocą środka dezynfekującego lub gorącej wody i małej ilość detergentu.

Po włożeniu żołędzia do Bigg Master powoli i dobitnie naciągnąć komorę żołądzia.

Żołądź ma pozostać na komorze żołądzia, w pełnym zakresie (w stosownych przypadkach podnieść pierścień śluzy dla celów kontroli wzrokowej).

[!] Dla nieobrzezanych penisa (z napletka)

Jeśli napletek jest również zasysany do komory żołądzia, należy wyciągnąć napletka ponownie.
W tym celu, na krótko otworzyć zawór do minimalnego zakresu w celu usunięcia komory próżniowej.

Jeśli żołądź wymyka się z komory żołądzia częściowo za pomocą wyżej wymienionych, zapraszamy do ponownego usunięcia powietrza przez pompowanie (patrz strona 26, odpowiednio, 28).

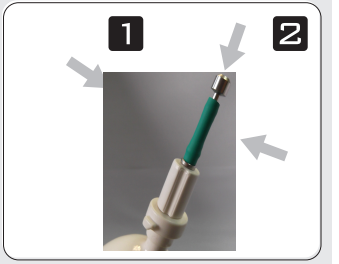

2. e) ścisnąć zawór wężyka, zdjąć wężyk przedłużający, i włożyć wtyczkę uszczelniającą

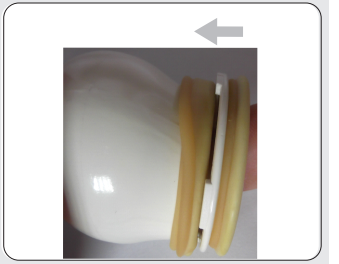

Pociągnij powoli by sprawdzić mocowanie komory żołądzia

[!] Teraz możesz podłączyć Bigg Master do szelek naciągowych (patrz strona 34) lub urządzenie z prętami dystansowymi (patrz strona 46, 47).

Zdejmowanie Bigg Master

PL

Otworzyć zawór co najmniej o pół obrotu(w prawo). Zazwyczaj Bigg Master sam zejdzie z żołądzia. Jeśli nie zsunie się w czasie krótszym niż jedna minuta można usunąć używając niewielkiej siły.

KRÓTKA INSTRUKCJA

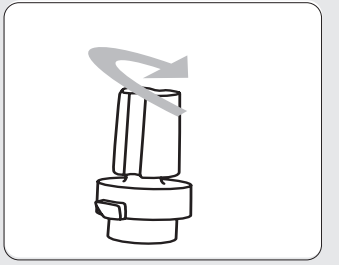

Zdejmowanie przez otwarcie zaworu

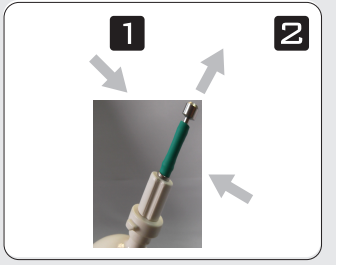

Wyciągnij wtyczkę z wężyka w celu zdjęcia urządzenia

Czyszczenie Bigg Master

Ze względów higienicznych należy oczyścić Bigg Master zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Odpowiednie środki myjące i metody

Proszę używać do oczyszczania, odkażania i środków do pielęgnacji dostosowane do Bigg Master.

Proszę używać specjalnych środków zamiast mydła !

Alternatywnie, można oczyścić części przy użyciu detergentu i wody. Proszę nie używać żadnego mydła, środków czystości, lub podobnych, ponieważ mogą uszkodzić lateks.

Części plastikowe Bigg Master nie mające bezpośredniego kontaktu z penisem, to wystarczy użyć obojętny detergent i wodę, wszystkie części mogą zostać zanurzone całkowicie w taki sam sposób.

Wysokie temperatury (lub urządzenia do dezynfekcji termicznej) mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i komponentów.

Nie podgrzewaj urządzenia lub ich części !

2. Szybkie procedury pośredniego oczyszczania

Po przerwaniu systemu wydłużania w krótkich okresach czasu (np oddawania moczu) można wytrzeć wilgoć z lateksu za pomocą papierowego ręcznika.

PL

3. Oczyszczanie raz dziennie podczas aplikacji

3.1 Oczyszczanie poprzez zastąpienie części lateksowej
Procedura oczyszczania układu zalecana jest codzienna wymiana wszystkich części lateksu Bigg Master (patrz strona 20 i nast.).

3.2 Czyszczenie bez demontażu części lateksowej
Jeśli żel i pielęgnacja (pozycja nr ZPMP - 001 jest traktowany i używany ostrożnie, można użyć zainstalowanych części lateksu do 10 dni dłużej.
W ten sposób minimalizuje się koszty zastosowania.
Proszę oczyścić zainstalowane części lateksu jak następuje na co dzień:

a) Odessać powietrze za pomocą pompki (patrz strona 25) lub system aplikacji wężyka (patrz strona 27), tak aby Membrana zetknie się z wewnętrzną ścianką komory żołądzia.

b) Napełnić komorę żołądzia z detergentem i wodą lub przez zanurzenie całkowicie do wody z detergentem.

c) Za pomocą palca wytrzeć wewnętrzną ścianę komory żołądzia kilka razy.

d) W celu oczyszczenia śluzę, pociągnij w przód iw tył palcem kilka razy.

e) Opróżnić komorę żołądzia.

f) Za pomocą czystej wody opłukać.

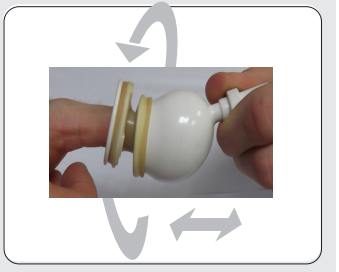

3.2 a - f) Proste oczyszczanie wodą z detergentem membrany

Paznokcie mogą spowodować uszkodzenia elementów lateksowych !

4. Suszenie bez demontażu części lateksowych

a) Napełnić komorę żołądzia miękkim ręcznikiem papierowym i wyciągnąć.

b) Otworzyć zawór, aby usunąć podciśnienie z membrany.

Czysty Bigg Master jest gotowy do ponownego użycia.

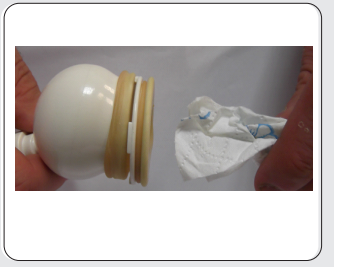

4. a - b) Suszenie części lateksowych miękką chusteczką

Bigg Master z naciągiem szelkowym

System szelek został opracowany specjalnie dla używania razem z Bigg Master i pozwala na wszechstronne naciągnie penisa w celu wydłużenia.

System naciągania szelkowego może być noszony w najbardziej różne sposoby, na przykład podobne do zawieszeniu jako pas na ramię, albo w pasie biodrowym, a nawet za kolano.

PL

Każda technika z wymienionych powyżej ma swoje zalety, które zostały opisane bardziej szczegółowo w zastosowaniu.

System szelek Bigg Master może być noszony niepostrzegalnie pod normalną odzieżą, w pasie biodrowym nawet ze zwykłą bielizną.

System szelek nie ogranicza podczas codziennych zajęć, np. jazda na rowerze.

System szelek naciągu jest podłączony do żołędzia za pomocą urządzenia mocującego Bigg Master. Drugi koniec szelek albo jest przymocowany do korpusu (udo, kolano) lub do odzieży (spodnie) dzięki użyciu zacisku mocującego w zależności od żądanego wariantu noszenia.

KRÓTKI PRZEWODNIK

Wszechstronne ćwiczenie na podstawie wszechstronnych wariantów aplikacji

Każda technika ma swoje zalety.

Dyskretne, elastyczne, praktyczne

Noszenie według wariantu Bigg Master w pasie
System: szelek na ramię, pas biodrowy, pas kolano

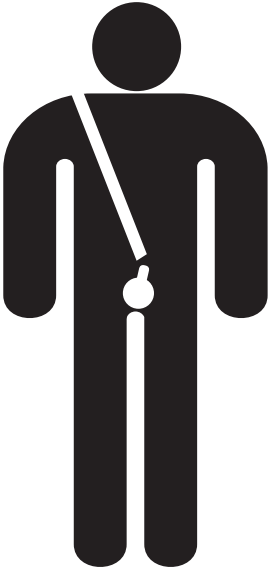

PL

Lista części i nazwa części

Bigg Master systemu szelek naciągowych

PMP-003)

PL

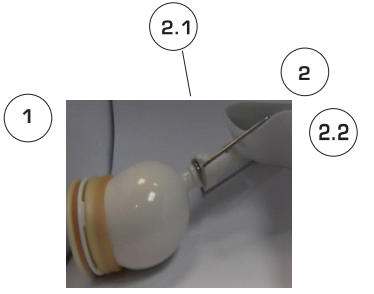

1 **Bigg Master**

(system podstawowy)
Art.-Nr. PMP-001

2 **System szelek naciągowych**

dla Bigg Master
EPMP-007

Długość szelek należy dostosować po obu stronach na regulatorach (2.3) zaczepy (2.4) i łącznik (2.1)

2.1 umożliwiają podłączenie do szelek Bigg Master (1)

2.2 Szerokość: 4 cm, nastawna długość: 70 do 140 cm, Poniżej siła uciągu 1 kg ok. 90 do 240 cm.

2.3 Aby dopasować długość szelek (2.2) do każdego ciała służą regulatory (2.3), które są zawsze w zasięgu ręki do wszystkich metod wydłużania.

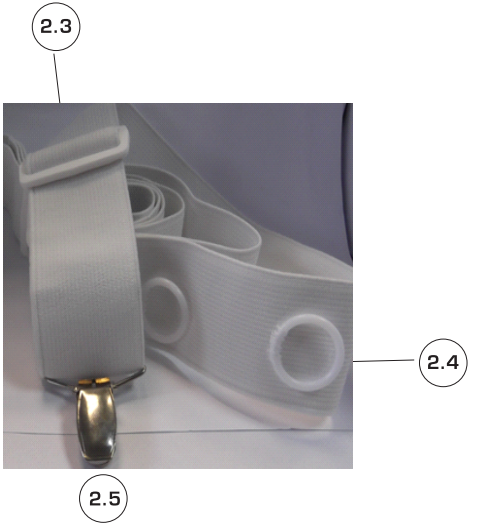

2.4 **Zaczepy 5 pozycyjne** pozwalają na zastosowanie specjalnych technik (np. zawinięcie poniżej stawu kolanowego), bez niepokojących zmarszczek szelek naciągowych (2,2).

2.5 **Mocowanie zaczepu** Dołącz wolny koniec szelek naciągowych (2,2) do zaczepu w dowolnej naciągniętej pozycji (2,4), lub nawet do talii.

Noszenie na pasie biodrowym
O tym sposobie:

- siły naciągowe niemal równe we wszystkich pozycjach ciała
- silniejsze siły ciągnącej na jednej stronie penisa
- Korzystne dla korekty krzywizn penisa do stosowania po stronie lewej lub prawej

PL

Sposób zastosowania

[!] Bigg Master powinien być już być dołączony do penisa (patrz strona 20 i. nast.).

(1) Ustawić regulator szelek od strony głównego zaczepu bezpośrednio przed pierwszym zaczepem (kółkiem) tak samo na drugim końcu szelek obok zaczepu żabkowego.

(2) Wsunąć wąski segment głowicy złącza Bigg Master do występu z gniazdem łączącym (1) i wyciągnąć pas (2).
W ten sposób, obie części są połączone.

KRÓTKA INSTRUKCJA

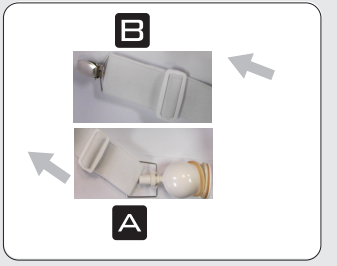

1. Ustaw długość paska zgodnie z obwodem

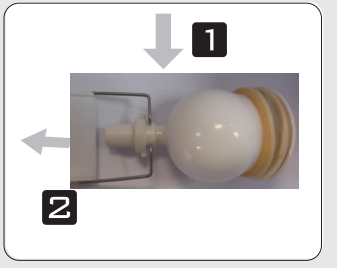

2. Podłącz szelki do Bigg Master

Zastosowanie w pasie biodrowym

a) Opcjonalnie ułożenie z prawej lub z lewej strony, tak aby Bigg Master znajdował się powyżej kości biodrowej.
b) ułożenie szelek wokół tyłu
c) ułożenie swobodnie wokół ud oraz z przodu w okolicy pachwiny.
d) zapięcie do szelek wielu pozycji.
e) Za pomocą mocującej klamry do regulacji długości taśmy w taki sposób, że twój penis jest wydłużony w zauważalny i wygodny sposób, za pomocą siły ciągnącej szelek (200 -1100 gramów; patrz strona 56 i. nast.). Można również dostosować uzwojenia wokół uda wymagane w ten sposób.

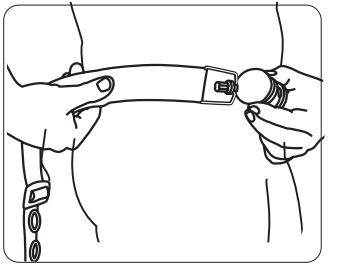

a - b) Ułożenie wokół bioder i pasa tyłu

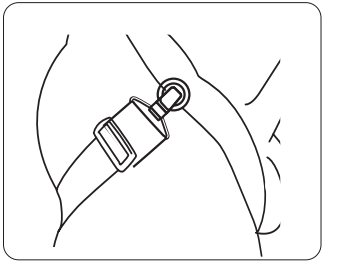

c-d) Owinąć szelki wokół nogi i zapiąć za pomocą żabki

e) Regulacja siły uciągu

PL

Uwaga:

Podczas korzystania z tego wariantu powinieneś sobie zmieniać kierunek naciągu z dnia na dzień. Jeśli chcesz poprawić skrzywienie penisa w jednym kierunku, można wdrożyć wydłużenie jedynie w kierunku przeciwnym do krzywizny (np. krzywizna w lewo = stosowania pasa do prawej).

Noszenie, wariant szelki na ramię o

tym wariancie na ramię

- osiowo, symetrycznie wydłużenie w kierunku do góry, podobne procedury z systemem prętów dystansowych
- siła ciągnięcia zmienia się w zależności od położenia górnego część korpusu.
- Jeśli penis wystaje ponad pas w kierunku do góry, to pozycja nie powinna hamować procesu wydłużenia.
- W celu ochrony prywatności należy nosić koszulę na spodnie.

PL

Urządzenie gotowe do stosowania

[!] Bigg Master już może zostać zastosowany do penisa

(patrz strona 20 i nast.).

Uwaga:

Normalnie, gdy system szelek zastosowany będzie jako pas barkowy, szelki muszą być zastosowane na stosunkowo krótkiej długości.

Informacje o regulacji

Długość szelek naciągowych jest przystosowana do wzrostu o ok. 175 cm przy normalnej wadze jeśli jest inaczej, należy dostosować indywidualnie inaczej. W tym systemie klamra główna ok. 15 centymetrów od naciągu i zaczepu B kolejne 15 centymetry od ww.

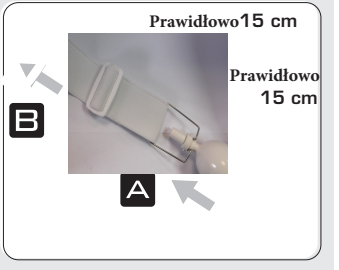

Wstępnie ustawić długość szelek

Uwaga:

W tym celu możesz przełożyć zaczepy przez regulatory w dowolne miejsce.

Zakładanie szelek na ramię

a) Zapięcie szelek po stronie lewej lub prawej strony pas tylny.
b) Przełożyć wolny koniec szelek ukośnie przez ramię
(czyli wtedy, gdy przyłączony zaczep na przykład do prawego tylnego boku, ułożenie szelek nad prawym ramieniem do przodu).

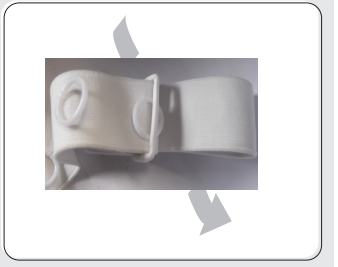

Możesz przełożyć zaczepy przez regulatory w dowolne miejsce

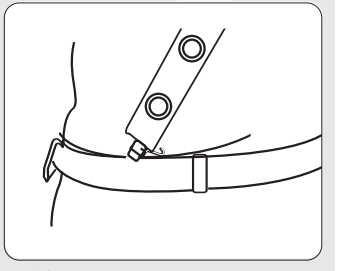

a - b) Przypiąć szelki do tylnej części spodni i przełożyć do przodu ukośnie przez ramię

c) Naciśnij wąski segment głowicy złącza Bigg Master do występu z gniazdem łączącym(1), a naciągniętymi szelkami (2).
W ten sposób, obie części są połączone w odpowiedni sposób

ci) Za pomocą głównej klamry do regulacji długości szelek w taki sposób, że twój penis jest wydłużony w zauważalny i wygodny sposób, za pomocą siły ciągnącej szelek (200 -1100 g; patrz strona 56 i nast.).
I zostaje osłonięty za pomocą koszuli.

PL

Uwaga:

Proszę zauważyć, żeby spodnie były wystarczająco luźne, w celu aby nie przycisnąć Bigg Master. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu do talii, jeśli twój penis wystaje nad paskiem.

KRÓTKA INSTRUKCJA

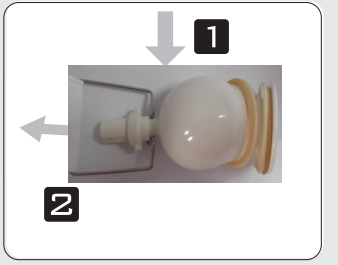

c) Połączyć szelki z Bigg Master

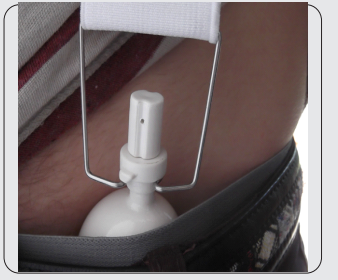

d) Dostosować siłę ciągnącą regulując długość szelek i przykryć system koszulą

Uchwyt szelek do kolan

O tym sposobie mocowania

- osiowo symetryczny wydłużenie w kierunku ku dołowi podobna procedury z naciągiem prętów dystansowych siła naciągu zmienia się w zależności od położenia nóg
- dynamiczny (zwiększenie / zmniejszenie) wydłużenie przy każdym obciążeniu krok = dobre dopełnienie ćwiczenia wydłużenia wariantów
- Jeśli wychodzisz z domu należy nosić spodnie z szerokimi nogawkami

Przygotowane do noszenia

[!] Bigg Master jest już gotowy do użycia (Patrz strona 20 i. Nast.).

Uwaga 1:

Informacje o regulacji długości pasa dotyczy: Wysokość ciała ok. 175 cm w normalnej wagi, w innym przypadku musi być dostosowane indywidualnie.

Uwaga 2:

Nawijanie szelek wokół kolana wymaga trochę prób i doświadczenia.

1. Zaczep główny szelek ok. 10 centymetrów od uchwytu łączącego i regulatora B, kolejne 10 centymetrów następnych zaczepów.

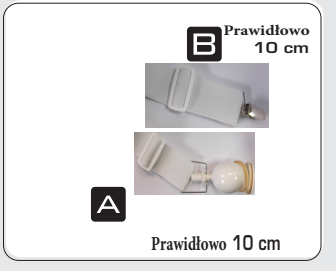

1. Wstępnie ustawić długość szelek

PL

2. Naciśnij wąski segment głowicy złącza

Bigg Master do występu z gniazdem łączącym(1),
a naciągniętymi szelkami (2).
W ten sposób, obie części są połączone w odpowiedni sposób.

Zastosowanie jako szelki do kolana

a) Ustawić się na krześle tak, że uda i podudzia tworzą kąt prosty.
b) Rozpocząć od przedniej strony, owinąć szelki poniżej rzepki tak by Wywierany był średniej siły naciąg, a szelki leżały w zakolu kolana.
c) Owiń szelki kolejny raz bezpośrednio pod rzepką.
d) Chwytając z dołu poprowadzić szelki z dołu, w kierunku swobodnego końca wokół części szelek prowadzących do penisa i owinąć raz lub dwa razy wokół kolana.

KRÓTKA INSTRUKCJA

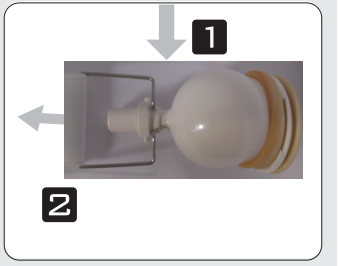

2. Połączyć szelki z Bigg Master

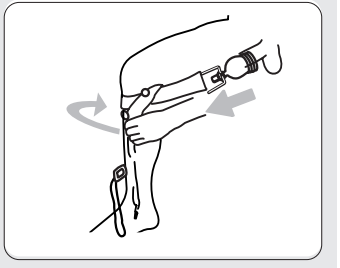

a - d) Owiń szelki kolejny raz bezpośrednio pod rzepką.

e) Zamocować zaczep (żabkę) do jednej z wielu pozycji zaczepów, na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie kolana, jeśli to możliwe.
f) Wstać
g) Użyj regulatora długości szelek w ten sposób, że penis jest wydłużony zauważalne i wygodny (200 -1100 g; patrz strona 56 i nast.).

Czyszczenie i konserwacja

Jeśli to konieczne, można myć lub prać szelki naciągowe do temperatury 60 stC.

W celu uniknięcia uszkodzenia innych części garderoby, zalecamy pranie szelek naciągowych w sieci pralni.

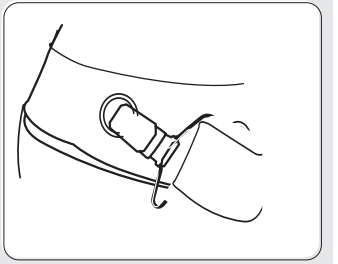

e) Zamocować zaczep (żabkę) do jednej z wielu pozycji zaczepów

f - g) Wstać i dostosować długość szelek naciągowych

PL

Bigg Master w wersji z prętami dystansowymi

W swojej podstawowej konstrukcji od wielu lat sprawdził się z paskami zaciskowymi.
Precyzyjna obróbka i innowacyjna funkcjonalność zapewnia długoterminową trwałość, bezpieczeństwo i komfortu obsługi.

System prętów dystansowych w połączeniu z Bigg Master pozwala na wydłużanie penisa w sposób osiowy i symetryczny bez oparcia daleko od prącia (miejsca przyłączenia). Siła ciągnąca jest prawie taka sama we wszystkich pozycjach penisa.

Sprawdzona metoda naciągu

Stosując urządzenie z wersją z prętami dystansowymi penis może być wydłużony albo w górę lub ukośnie w dół.
Bigg Master jest dyskretny, nawet w normalnych ubraniach. Tak więc, wiele działań codziennego życia może być realizowane bez żadnych problemów.

Bigg Master w wersji z prętami dystansowymi pozwala na unikalny sposób zabiegu: wydłużenie w pozycji fizjologicznej (wzniesiony penis). W tym przypadku penis może być wydłużony kątowo od korpusu, podobne do naturalnego wznoszenia.

Ta metoda nie jest dyskretna i możliwa do wykonania w domu (np. podczas oglądania telewizji).

Aplikacja ta jest idealnym ćwiczeniem z fizjologicznego punktu widzenia.

Pozwala również na idealne fizjologiczne wydłużeniu penisa pod kątem prostym do ciała

Lista części i nominał części
Bigg Master w wersji z prętami dystansowymi
(PMP-002)

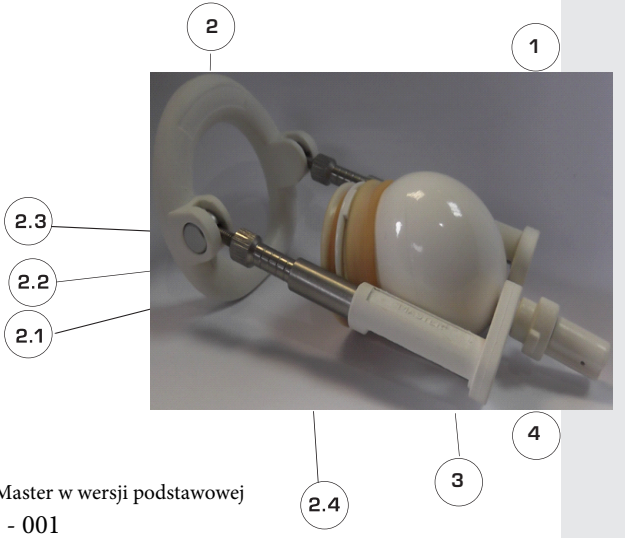

1 Bigg Master w wersji podstawowej
PMP - 001

2 Podstawowa wersja z pierścieniem mocującym
EEK - 003.i

Pierścień mocujący wykonany jest z tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego, o wysokiej wytrzymałości ukształtowany w płaskiej, nie łukowej dolnej stronie tak, że wersja z prętami dystansowymi może być noszone w przekątnej do góry, lub do dołu.

PL

PL

2.1 **Kontrola siły naciągu**
w położeniu nie naciągniętym widzimy siłę naciągu na nacięciach tulejki, w momencie naciągania wywierana jest siła naciągu na penis i można to zaobserwować na 5 stopniowej skali do ok. 1100 gramów. Większej siły nie zalecamy, ale też jest widoczna na podziałce.

2.2 **Śruba z gwintem** służy do dokładnego i ponownego dostosowania długości pręta i siły ciągnącej wywieranej na penis.

2.3 **Złącza obrotowe**, (zawiasy obrotowe) zapewniają dowolność noszenia o 180 stopni w w górę lub w dół, w kierunku do lub od ciała w prawo i w lewo.

2.4 **W celu przyłączenia** Big Master do prętów dystansowych stosuje się gniazdo łączące (4).
Do zestawu Bigg Master stosuje się pręty dystansowe (3).

3 **Podstawowe pręty dystansowe**
EEK-004
Stosuje się pary prętów dystansowych z zakresem wymiarowym:
5 mm, 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm.
W każdym zestawie występują 3 x 5 mm, aby dopasować długość wymaganą z dokładnością do milimetra.

Dzięki prętów dystansowych można przedłużać penis do 30 cm.

4 **Gniazdo łączące**
EPMP-006
Bigg Master (1) łączymy z gniazdem łączącym, następnie wciskamy na pręty dystansowe wcześniej przygotowane na odpowiednią długość razem z pierścieniem mocującym 2.4, odpowiednio od góry (klip).

3

4

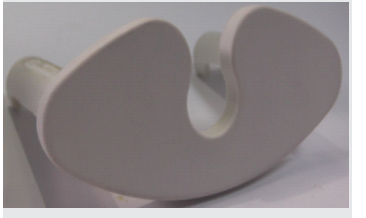

Zastosowanie urządzenia

Przygotowanie

[!] Bigg Master już został zamontowany penisa (patrz strona 20 i nast.).

Zamontowanie prętów dystansowych do urządzenia

a) Obróć pierścień podstawowy w sposób: napis "Master" do góry b)

nałożyć gniazdo łączące na pręty dystansowe.

c) Ustawić długość prętów:
Regulowanie ogólnej długości urządzenia (co odpowiada w przybliżeniu długości penisa plus 1,5 cm).
Pręty dystansowe są przykręcane ze sobą w dowolnej kombinacji parami.
Wyniki w następujących długościach:
10 cm rozszerzenie (pręty 8 + 2), 12 cm (8 + 4), 14 cm (8 + 6), 16 cm (8 + 2 + 6), 18 cm (8 + 4 + 6), 20 cm (8 + 2 + 4 + 6).

[!] Pręty dystansowe o wymiarze 5 mm służą w celu dokładnej regulacji + 0,5, 1,0 lub 1,5 cm.

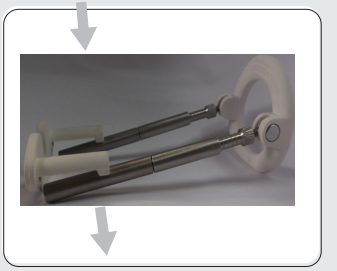

1. a - b) Obróć pierścień podstawowy w sposób: napis "Master" do góry

1. c) Regulowanie ogólnej długości urządzenia (co odpowiada w przybliżeniu długości penisa plus 1,5 cm)

2. Podłączenie do Bigg Master

a) wsunąć penisa wraz z Bigg Master przez pierścień podstawowy

b) naciśnij pręty dystansowe w kierunku ciała, aż do granicy

c) ustawić Bigg Master z penisem w urządzeniu naciągu

d) naciśnij zwężenie w Bigg Master wkładając do wyżłobienia w gnieździe łączącym

W ten sposób obie części są połączone.

PL

KRÓTKA INSTRUKCJA

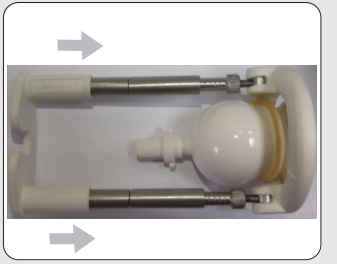

2. a - c) naciśnij pręty dystansowe w kierunku ciała

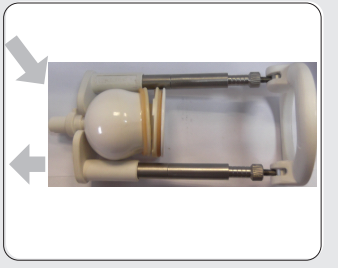

2. d) naciśnij zwężenie w Bigg Master

3. Regulacja siły ciągnącej

Przykład odczytu naciągu sprężyny:
jeżeli urządzenie na przykład jest w pozycji widocznej tylko 3 kreski z podziałki na 5 kresek, regulowana siła ciągnąca jest między 450 a 650 gramów.
Jeśli możesz przeczytać tylko ostatnie oznakowanie (kreskę), to siła ciągnąca jest między 920 a 1100 gram.

W celu zwiększenia wydłużenia prącia, należy przekręcić obie śruby ustalające jednakowo w prawo w kierunku ruchu wskazówek zegara.

To zwiększa całkowitą długość urządzenia.

W celu zmniejszenia siły naciągu, odkręcić śruby regulacyjne w przeciwnym kierunku
(w lewo w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Uwaga 1:

Gwintowane śruby muszą być odkręcone, wtedy penis będzie wydłużany o wybraną długość pręta (patrz strona 49).
W przeciwnym razie, będzie niewystarczająca siła ciągnąca !

Uwaga 2:

Normalnie, siła ciągnąca jest ograniczona automatycznie, gdy urządzenie jest składane w górę lub w dół z pozycji poziomej.

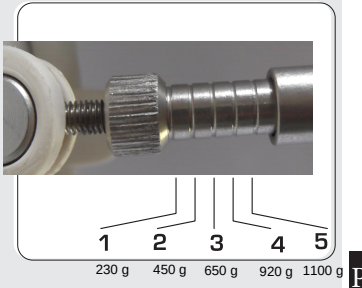

3. Dostosować siłę ciągnącą od 200 do 1100 gramów

PL

Uwaga 3:

Jeśli penis wydłuża się samoczynnie w niedługim czasie po zainstalowaniu urządzenia (zazwyczaj po 10 - 20 minut), to siła ciągnienia zostaje zmniejszona, należy ponownie ustawić wcześniejsze siły za pomocą gwintowanych śrub podstawowego pierścienia!

PL

WSKAZÓWKA:

Wykwalifikowani użytkownicy dostosowują długość prętów dystansowych w taki sposób, że sprężyna jest wciśnięta prawie w całości w miarę możliwości. Należy ponownie ustawić wcześniejsze siły za pomocą gwintowanych śrub podstawowego pierścienia!
(patrz strona 51).

Czyszczenie i konserwacja

Możesz odtłuścić i oczyścić pręty dystansowe w letniej wodzie i mydłem lub detergentem.

Części metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej, chromowane, lub złocone (w zależności od odpowiednich modeli), a tym samym nie ulegają korozji.

Proste oczyszczanie urządzenia, bo nie ulega korozji

PL

Instrukcje szkoleniowe Bigg Master

Uwaga:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać sekcję "**Znane ryzyko i skutki uboczne"** na stronie 9,
a także " **Kiedy urządzenie nie może być używane?** " na stronie 9.

W oparciu o wysoki poziom komfortu, większość użytkowników dostrzega procedury ćwiczeń i masażu tkanki penisa z Bigg Master, jako bardzo wygodne i stymulujące jest działanie urządzenia.

Już po bardzo krótkim okresie czasu zapoznania się z urządzeniem życie może być tak dobre, że ludzie nawet nie czują Bigg Master.

Ma to pozytywny wpływ na ćwiczenia penisa w prawidłowy i skuteczny sposób, poprzez wydłużenie.

Czas trwania i częstotliwość stosowania

Ile godzin dziennie powinno się nosić Bigg Master ?

Istnieje prosta zasada: dłuższy i częstsze stymulowanie tkanki penisa z umiarkowaną siłą ciągnącą daje lepsze wyniki.

Tak więc twoim celem powinno być wydłużanie penisa przez co najmniej trzy godziny dziennie przy użyciu Bigg Master.

PL

Osiem do dwunastu godzin codziennego stosowania są idealne w celu osiągnięcia dobrych wyników. Po trzech godzinach używania należy zrobić przerwę regeneracyjną na pół godziny. Dłużej można zastosować urządzenie bez przerw, np w porze nocnej. Jednakże, jak w przypadku każdego innego ćwiczenia fizjologicznego można zastosować przerwy i fazy ćwiczenia na przemian, spowoduje to lepsze wyniki niż monotonne stałe obciążenia.

Jaki jest całkowity czas noszenia Bigg Master ?
Jeśli mają Państwo na celu osiągnięcie trwałego wydłużenie penisa, należy realizować ćwiczenia w okresie sześciu miesięcy lub dłużej, jeśli to możliwe. Już po upływie kilku tygodni, zauważysz, że penis staje się odpowiednio dłuższy i grubszy. Jednakże wyniki te są zdecydowane na podstawie efektów rozciągania Str. 55

Ponieważ każdy człowiek jest inny i tak indywidualnie każdego ciało inaczej reaguje na terapię stymulację, nie jest to możliwe dokładnie przewidzieć, jak długo należy stosować urządzenie w danym przypadku w stosunku do trwałych zmian penisa (wydłużenie, pogrubienie, prostowanie)

Są to indywidualne wyniki. Dotyczy to szczególnie leczenia choroby Peyroniego, Induratio penis plastica.
Jednak wyniki uzyskuje się po okresie od jednego do trzech miesięcy, i będzie utrzymywany na stałe.

Uwaga:

Lepiej trenować dłużej mniejszą siłą ciągnącą niż trenować krótki czas, tylko z dużą siłą !

Ustal cel:

co najmniej trzy, idealnie osiem do dwunastu godzin dziennie

Krótkie okresy stosowania spowoduje tymczasowe efekty rozciągania, trwałe rezultaty osiąga się po kilku miesiącach.

Czy dalsze wyniki mogą być osiągalne na przykład po roku lub nawet dłuższego zastosowania ?
Człowiek różni się od człowieka. Jednak najszybciej
można spodziewać się zwiększenia efektów trakcie pierwszego pół roku intensywnej aplikacji.

Niezależnie od wyżej wymienionych, Bigg Master można używać jak długo chcesz.

Czy przerwy w stosowaniu mogą mieć negatywny wpływ na używanie?
Efekty terapeutyczne osiągane w krótkich okresach aplikacji są tymczasowe.

Efekty terapii uzyskuje się na podstawie długotrwałego szkolenia i będą zachowane nawet po przerwaniu stosowania.

W ten sposób należy dążyć do korzystania z urządzenia przez kilka miesięcy, poprawione wyniki mogą być po zastosowaniu kilkudniowej przerwy.

Przerwy mogą mieć pozytywny wpływ na wynik leczenia.

PL

Prawidłowa siła ciągnąca

Podczas aplikacji należy osiągnąć siłę ciągnienia 200 g w górę do maksymalnie 1100 g przez co najmniej jedną godzinę, jeżeli nie będzie żadnych problemów lub niewygodne odczucie.

Następnie można zwiększyć siłę ciągnąca, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości, na których można korzystać z urządzenia na stałe do trzech godzin bez żadnych problemów.

Wartości pomiędzy 280 i 400 gram, są to dobre wartości dla stałego ćwiczenia.
Nawet jeśli penis jest cieńszy niż normalnie w stanie wydłużonym w tym samym ćwiczenie nie tylko spowoduje wydłużenie prącia, ale również pogrubienie.

Regulacja siły ciągnącej.
Zasadniczo należy używać urządzenia tak, by nie sprawiało bólu, a było czuć siłę naciągnięcia.

Tą metodę należy stosować intuicyjnie właściwie do swoich możliwości.

Uwaga:

System Bigg Master jest w stanie stosować siły ciągnące do penisa znacznie przekraczające wartości zalecane i zakres wskazania wagi sprężynowej.

Jednakże, takie duże siły ciągnące niekoniecznie mają pozytywne efekty i wyniki.

Uwaga:

Nawet jeśli penis jest cieńszy niż normalnie w stanie wydłużonym w tym samym ćwiczenie nie tylko spowoduje wydłużenie prącia, ale również pogrubienie.

Uwaga:

Należy również przestrzegać podanych instrukcji w odniesieniu do regulacji siły ciągnącej.

Noszenie urządzenie powinno być zawsze wygodne!

Ważne jest, że postrzegasz aplikację jako wygodne w każdym czasie. Jeśli czujesz ból lub wystąpienia innych niepożądanych efekty ubocznych, takie same mogą być przypisane do nadużyć lub przeciążenie.

W takich przypadkach należy zaprzestać korzystania z urządzenia i poczekać aż do ustąpienia objawów
(patrz "Znane zagrożenia i efekty uboczne" na stronie 9).

Następnie, nadal trenować z niższą siłą naciągu i powoli przyzwyczaić się do większych obciążeń.

Noszenie urządzenie powinno zawsze być wygodne - w przeciwnym wypadku, nadużycia miały miejsce w większości przypadków!

PL

Noszenie urządzenia podczas snu

Chociaż regularne przerwy przynajmniej co trzy godziny
(patrz strona 54) są korzystne dla ćwiczenia penisa z fizjologicznego punktu widzenia, można użyć Bigg Master na rozszerzone okresy, jak również, na przykład podczas snu.

Prosimy o zapoznanie się ze sposobem i urządzenie i regulacji siły naciągu odpowiednie dla danego przypadku.

Powinieneś także przetestować planowany okres stosowania w czasie snu przy użyciu odpowiedniej siły ciągnięcia kilka razy w ciągu dnia.

Bigg Master w połączeniu z innymi metodami

Chęć przyspieszenia lub poprawy osiągalnych wyników, leczenie wydłużenie penisa poprzez wdrożenie towarzyszących środków jest zrozumiałe.

Ocena możliwości wyżej wymienionych:

Tabletki i maści na powiększenie penisa

Fakt, że nie istnieją skuteczne tabletki lub maści skutkujące powiększeniu penisa, a nawet w sprostowanie krzywizny.

PL

Udowodniono medycznie, hormony nie mają wpływu na wzrost. Efekty nie są widoczne w żaden sposób na ciałach jamistych prącia pod względem przyrostu naturalnego, ale na mięśnie.

Wręcz przeciwnie, ludzie starają się zwiększyć ich mięśnie masy za pomocą środków anabolicznych często cierpią z powodu penisa, bo staje się mniejszy. Preparaty, które są dostępne wyłącznie na receptę i mające skutki jak dopalacze potencji w przypadku zaburzenia erekcji nie powodują penisa coraz większym.

Wdrożenie techniki masażu lub odpowiednie ćwiczenia same nie prowadzą do coraz większego penisa.

W celu stymulacji wzrostu komórek w obrębie prącia musi być stymulowane przez znacznie dłuższy okres czasu niż to jest możliwe za pomocą masażu.

Tak więc, Bigg Master powinien być noszony kilka godzin dziennie, aby osiągnąć widoczne rezultaty.

Jednak stałe, masaże mają pozytywny wpływ na przepływ krwi w penisie, które mogą mieć pozytywny wpływ na budowę.

Bigg Master jest wystarczający. Dodatkowe środki rzadko mają sens i są niepotrzebne.

Zatem stosowanie Bigg Master razem z masażem są godne polecenia - tak samo dotyczy to aktywnych czynności seksualnych, bez których penis może również się zmniejszać na podstawie braku długotrwałego intensywnego przepływu krwi.

Pompy próżniowe / pompy hydrauliczne
Pompy próżniowe nie mogą być nadużywane (kilka godzin) na ćwiczenia, w celu wywarcia impulsu wzrostu na penisie.
Jednakże dodatkowo za pomocą pompy próżniowej w ramach wydłużenia leczenie może być korzystne w odniesieniu do wspierania powstawania komórek w prącia poprzez intensywny przepływ krwi, a tym samym dostarczanie tlenu.

Moc wsparcia
Efekty mogą być zwiększone dzięki podwójnej terapii.
W ten sposób, z użyciem pompy dodatkowo raz dziennie przez kilka minut jest godne polecenia.

Suplementy diety, żywienie
Dobrze zbilansowana dieta i ćwiczenia, odpowiednio stosowany sport daje dobre samopoczucie fizyczne i wspiera zarówno libido i potencję.

O ile nie wynikają one w diagnosable niedożywienia, diety suplementy, preparaty witaminowe, mineralne, w zasadzie są zbędne, odpowiednio zbędne dla organizmu i fizjologicznych funkcji.

URZĄDZENIE REHABILITACYJNE

PKWiU 32.50.23.0

PL

PRODUCENT, GWARANT, SERVIS, CZĘŚCI ZAMIENNE
urządzenia rehabilitacyjnego BIGG MASTER

AKSEL
PL 05-800 PRUSZKÓW
UL. GUZIKOWA 28
+48 22 728 81 81
peni@aksel-gmbh.com.pl